


Kundendaten	Auftraggeber: Gerät: Maschinen-Typ: Maschinen-Nr.:	Mustermann GmbH Hydraulik-Schrauber Hydraulikschrauber 123456789
Kalibrierung	Prüfer: Prüfdatum: Prüflabor:	Sebastian Walter 11.03.2009 i.e. Industrieelektronik GmbH Unterlettenweg 4 85051 Ingolstadt
Meßkette	Meßwertaufnehmer: Auswerteelektronik: Software-Version: Sonstiges:	T061 SMH 100 T068 IFcalibra/u 2020 SN 120 3.6H ---
Rückführbarkeit	Nationale Normale: Toleranzen:	Alle ausgewiesenen Messwerte wurden auf einer Prüfeinrichtung ermittelt, deren einzelnen Messmittel einer regelmäßigen Prüfung unterliegen. Damit ist die Rückführbarkeit auf nationale Normale gemäß ISO 9001 ff gewährleistet. Dokumentation gemäß Anlage KV. Siehe Anlage KV
Sonst. Prüfungen	Winkelfunktion: E-Check: Optisch: Dichtigkeit:	nicht zutreffend/anwendbar nicht zutreffend/anwendbar keine Beanstandungen keine Beanstandungen
Hinweise	---	---
Gültigkeit	Modi: Dauer: Auflagen:	nicht zutreffend/anwendbar Die Gültigkeit dieses Werkskalibrierscheins beträgt 1 Jahr. Der Betreiber ist für die rechtzeitige Neukalibrierung verantwortlich. Dieser Werkskalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge bedürfen der Genehmigung des Ausstellers. Werkskalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit.

Datum: 11.03.2009 Unterschrift:

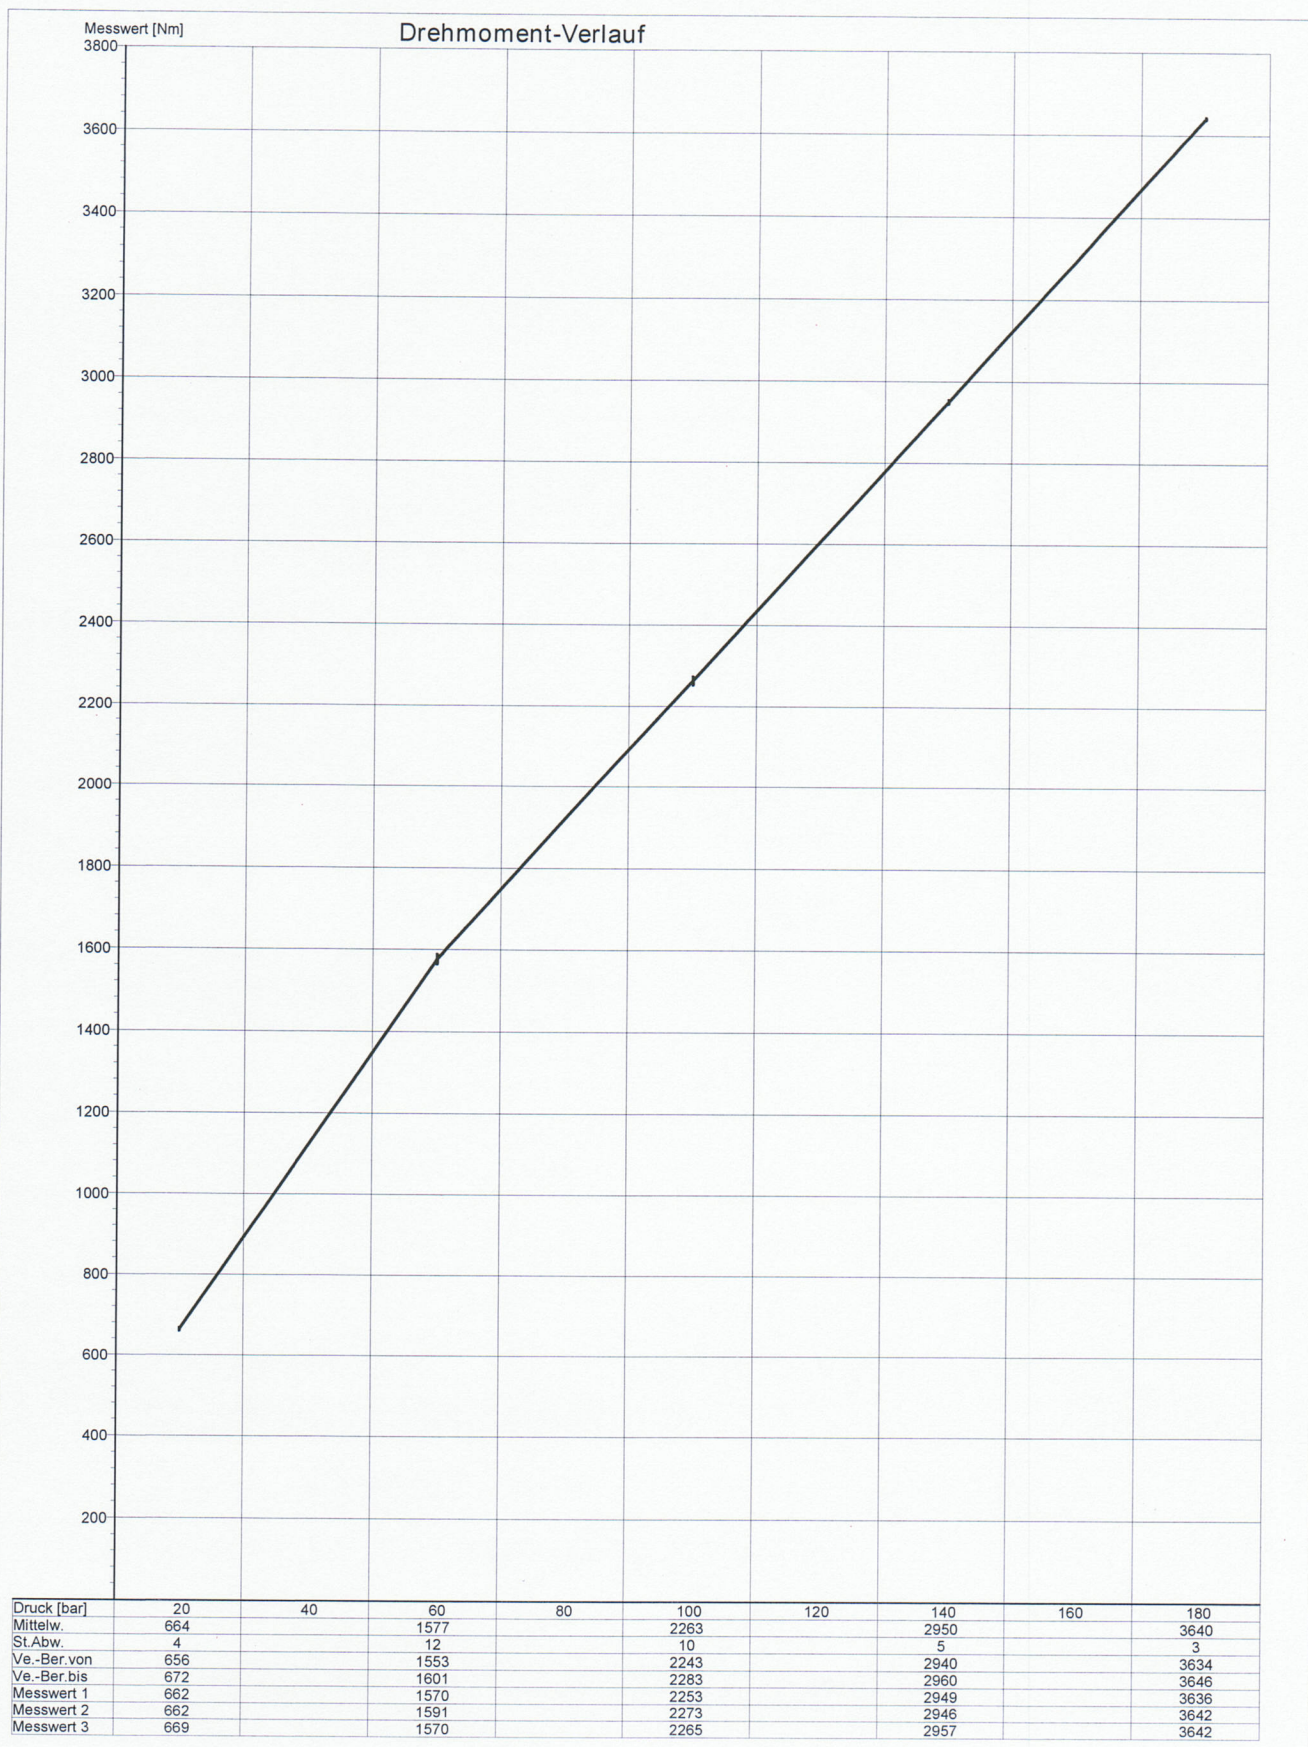

Errechnete Einstellwerte

bar	Nm	bar	Nm	bar	Nm
0	0	305	5796	610	11057
5	131	310	5882	615	11143
10	262	315	5968	620	11230
15	394	320	6055	625	11316
20	525	325	6141	630	11402
25	657	330	6227	635	11488
30	788	335	6313	640	11575
35	919	340	6400	645	11661
40	1051	345	6486	650	11747
45	1182	350	6572	655	11833
50	1314	355	6658	660	11920
55	1445	360	6745	665	12006
60	1577	365	6831	670	12092
65	1662	370	6917	675	12178
70	1748	375	7003	680	12265
75	1834	380	7090	685	12351
80	1920	385	7176	690	12437
85	2005	390	7262	695	12523
90	2091	395	7348	700	12610
95	2177	400	7435		
100	2263	405	7521		
105	2348	410	7607		
110	2434	415	7693		
115	2520	420	7780		
120	2606	425	7866		
125	2692	430	7952		
130	2778	435	8038		
135	2864	440	8125		
140	2950	445	8211		
145	3036	450	8297		
150	3122	455	8383		
155	3208	460	8470		
160	3295	465	8556		
165	3381	470	8642		
170	3467	475	8728		
175	3553	480	8815		
180	3640	485	8901		
185	3726	490	8987		
190	3812	495	9073		
195	3898	500	9160		
200	3985	505	9246		
205	4071	510	9332		
210	4157	515	9418		
215	4243	520	9505		
220	4330	525	9591		
225	4416	530	9677		
230	4502	535	9763		
235	4588	540	9850		
240	4675	545	9936		
245	4761	550	10022		
250	4847	555	10108		
255	4933	560	10195		
260	5020	565	10281		
265	5106	570	10367		
270	5192	575	10453		
275	5278	580	10540		
280	5365	585	10626		
285	5451	590	10712		
290	5537	595	10798		
295	5623	600	10885		
300	5710	605	10971		